

URZĄDZENIA SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-73
	Narzędzia medyczne Nożyczki typ Esmarch	5912-08
		Zamiast BN 64/5912 08
		Grupa katalogowa XIV 21 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nożyczki do przecinania opatrunków gipsowych typ Esmarch.

2. Normy związane


PN-69/Z-54061 Narzędzia medyczne. Ucha. Wymiary

PN-71/Z-54123 Narzędzia medyczne. Nożyczki ogólnochirurgiczne. Wspólne wymagania i badania

3. Oznaczenie

NOZYCZKI DO OPATRUNKÓW TYP ESMARCH BN-73/5912-08

4. Główne wymiary w mm

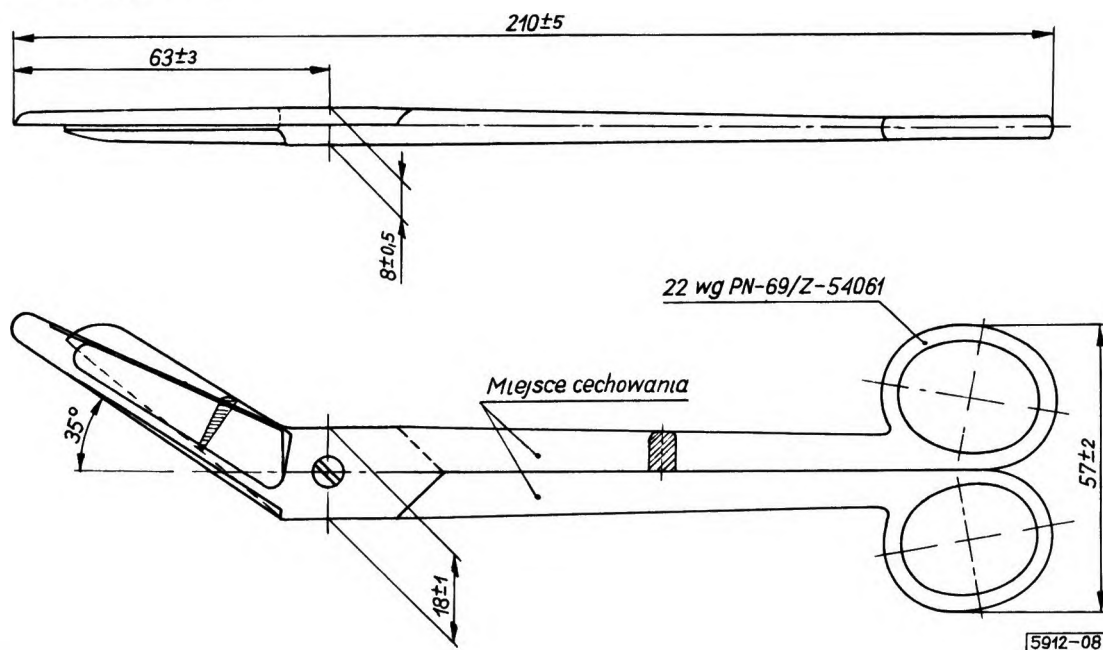

5. Ostrość krawędzi tnącej. Krawędzie tnące nożyczek powinny być naostrzone co najmniej na długości krótszego ramienia, ramię dłuższe nie powinno być naostrzone do samego końca.

6. Działanie. Ramiona nożyczek powinny być połączone w zamku w sposób zapewniający lekki i płynny obrót wokół osi bez wyczuwalnych zahamowań, przeskoków lub zatarć. Krawędzie tnące nożyczek przy zwieraniu i rozwieraniu powinny stykać się tylko w jednym punkcie przesuwającym się podczas ruchu ramion. Przy zwartych ramionach konce krawędzi tnących powinny zachodzić na siebie, lecz nie wychodzić poza linię grzbietu. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

1) Symbol wg SWW: 0973-119.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego
dnia 10 czerwca 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)

7. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nieuzbrojonym okiem. Sprawdzenie chropowatości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą wzorców porównawczych.

8. Pozostałe wymagania oraz badania powinny być zgodne z PN-71/Z-54123, z wyjątkiem 3.6, 3.7, 5.3.2 i 5.3.6.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/5912-08

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/5912-08

- a) wyeliminowano wymiary nieistotne,
- b) zmieniono miejsce cechowania,
- c) zmieniono wymagania dotyczące działania i oględzin zewnętrznych.