

URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Narzędzia stomatologiczne	5926-10
	Kleszcze protetyczne uniwersalne kramponowe, szpiczaste	
		Grupa katalogowa XIV 21

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są kleszcze uniwersalne kramponowe, szpiczaste stosowane do prac protetycznych

2 Normy związane

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) Gatunki

PN-57/Z-54093 Narzędzia lekarskie Nacięcia na narzędziach lekarskich

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Kleszcze protetyczne Ogólne wymagania i badania

3 Oznaczenie

KLESZCZE PROTETYCZNE UNIWERSALNE
KRAMPONOWE SZPICZASTE BN-68/5926-10

4 Główne wymiary w mm — wg rysunku


5 Materiał Części kleszczy powinny być wykonane ze stali następujących gatunków
ramiona — 3H13 — wg PN-66/H-86020,
kołek — 2H13 lub 3H13 — wg PN-66/H-86020

6 Twardość ramion po obróbce cieplnej powinna wynosić

rękojesci — $HRC = 43-48$,

części pracujących — co najmniej $HRC = 54$

7 Działanie Kleszcze powinny przecinać drut stalowy kwasoodporny sprężysty (np Remanit-federhart) o średnicy 0,9 mm na całej długości ostrzy Kleszcze nie powinny ulec trwałym odkształceniom ani uszkodzeniom krawędzi tnących

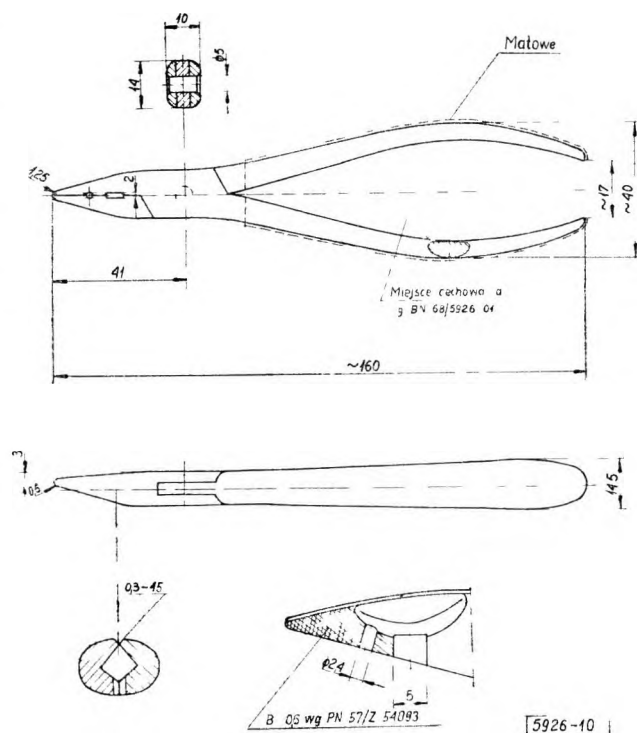

Po zamknięciu kleszczy krawędzie tnące szczęk powinny przylegać do siebie na całej długości

8 Pozostałe wymagania i badania — wg BN-68/5926-01

KONIEC

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed dnia 1 lipca 1968 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r
(Mon Pol nr 40/1968 poz 285)