

URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-71 5923-06
	Narzędzia stomatologiczne Upychadła jednostronne wygięte	
	Grupa katalogowa XIV 21	

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest upychadło jednostronne, wygięte do kanałów stosowane przy zabiegach stomatologicznych.

**2. Normy związane**

BN-71/5923-05 Narzędzia stomatologiczne. Upychadła, wydrążacze, zgłębniki. Wspólne wymagania i badania

**3. Odmiany.** Rozróżnia się dwie odmiany upychadeł jednostronnych wygiętych: 1 i 2.


**4. Przykład oznaczenia** upychadła jednostronnego wygiętego, odmiany 1:

UPYCHADŁO JEDNOSTRONNE WYGIĘTE 1 BN-71/5923-06

**5. Główne wymiary** w mm - wg rysunku.

**6. Sprężystość części pracującej.** Część pracująca powinna być tak sprężysta, aby siła o wielkości  $0,5 \text{ kg}$  (około  $5 \text{ N}$ ), przyłożona pod kątem  $45^\circ$  do końca części pracującej, nie powodowała trwałego odkształcenia.

**7. Pozostałe wymagania i badania** powinny być zgodne z BN-71/5923-05.

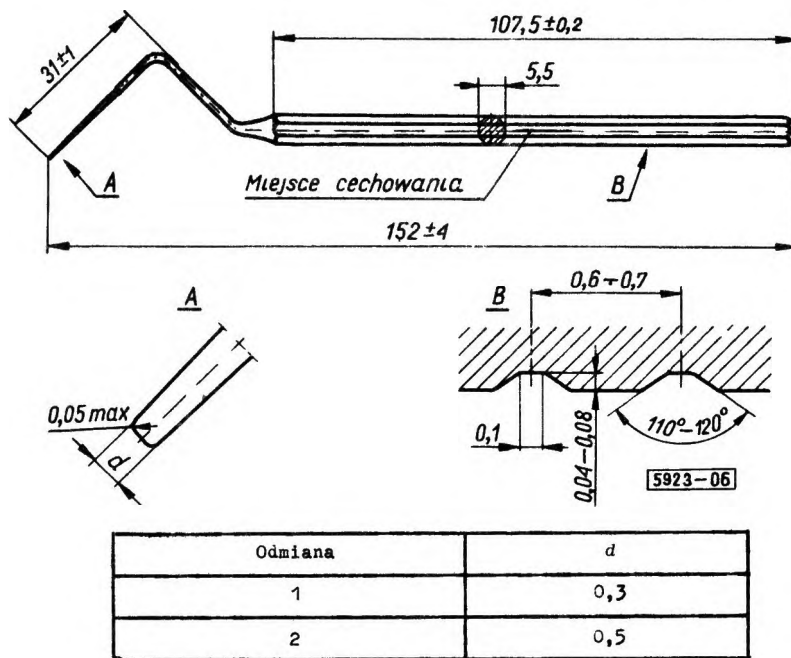

Dopuszcza się stosowanie pręta o średnicy koła wpisanego  $5 \text{ mm}$  zamiast  $5,5 \text{ mm}$ .

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/5923-06

Istotne zmiany w stosunku do PN-58/Z-56067

- norma obejmuje tylko upychadła jednostronnie wygięte,
  - zmieniono wymiary długości i części pracującej oraz zwymiarowano nacięcia rękojeści.
- Dotychczas obowiązująca PN-58/Z-56067 zostaje unieważniona z dniem 31 października 1971 r.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 4 marca 1971 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i badań odbiorczych od dnia 1 października 1971 r.  
(Mon Pol nr ) ( )

**7 BN-71/5923-06 Narzędzia stomatologiczne Upychadła jednostronne  
wygięte  
XIV 21**

**zmiana 1**  
26 3 73 r

Rysunek — wymiar długości rękojści  $107,5 \pm 0,2$  zmienia się na 107,  
— wymiar długości całkowitej  $152 \pm 4$  zmienia się na  $152 \pm 2$ ,  
— na szczegole B skresla się wymiary 0,1 i  $110^\circ - 120^\circ$

(Biuletyn PKNiM nr 7/73, poz 69)

**47 BN-71/5923-06 Narzędzia stomatologiczne Upychadła jednostronne wygięte  
XIV 21**

**zmiana 2**  
6 12 77 r

W punkcie 6 **Sprężystość części pracującej** tekst zmienia się następująco Część pracująca powinna być tak sprężysta, aby siła o wielkości 2,5N — dla odmiany 1 i 5N — dla odmiany 2, przyłożona pod kątem  $45^\circ$  do końca części pracującej, nie powodowała trwałego odkształcenia

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 7/73 poz 69

(Biuletyn PKNiM nr 4/78 poz 36)