

URZĄDZENIA SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-73
	Narzędzia medyczne Skrobaczki do macicy typ Recamier	5916-09
		Grupa katalogowa XIV 21 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skrobaczki do macicy typ Recamier używane przy zabiegach ginekologicznych.

2 Normy związane

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

PN-73/Z-58022 Narzędzia medyczne. Skrobaczki ginekologiczne. Wspólne wymagania i badania

3. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje skrobaczek do macicy typ Recamier:

0 - ostre,


T - tępe.

4. Wielkości. W zależności od szerokości części pracującej skrobaczki rozróżnia się osiem wielkości skrobaczek oznaczonych kolejno numerami od 1 do 8.

5. Przykład oznaczenia skrobaczki do macicy typ Recamier tępej (rodzaj T), o szerokości $a = 12$ mm (wielkość 5)

SKROBACZKA DO MACICY TYP RECAMIER T-5 BN-73/5916-09

6. Główne wymiary w mm

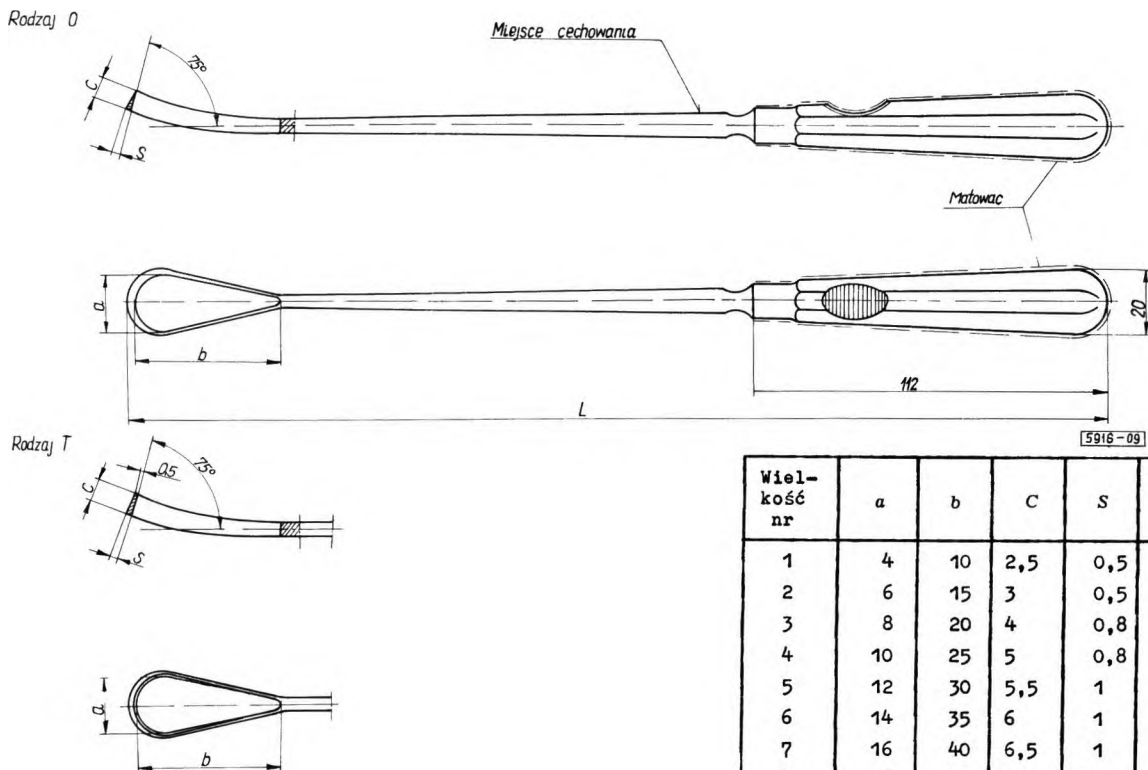

Wielkość nr	a	b	c	s	L
1	4	10	2,5	0,5	275
2	6	15	3	0,5	280
3	8	20	4	0,8	285
4	10	25	5	0,8	290
5	12	30	5,5	1	295
6	14	35	6	1	300
7	16	40	6,5	1	305
8	18	45	7	1	310

7. Materiał. Skrobaczka powinna być wykonana z następujących materiałów: część pracująca - stal nierdzewna 2H13 wg PN-71/H-86020, rękojeść - stal nierdzewna OH18N9 lub 1H13 lub OH13 wg PN-71/H-86020.

8. Pozostałe wymagania oraz badania powinny być zgodne z PN-73/Z-58022.

K O N I E C

¹⁾Symbol wg SWW: 0972-614.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego
dnia 26 marca 1973 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 19/1973 poz 54)