

URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Narzędzia stomatologiczne	5926-07
	Kleszcze protetyczne uniwersalne kramponowe, zwykłe	Zamiast BN 64/5926-07
		Grupa katalogowa XIV 21

**1 Przedmiot normy** Przedmiotem normy są kleszcze uniwersalne kramponowe, zwykłe stosowane do prac protetycznych

## 2 Normy związane

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nie-rdzewna i kwasoodporna) Gatunki

PN-57/Z-54093 Narzędzia lekarskie Nacięcia na narzędziach lekarskich

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Kleszcze protetyczne Ogólne wymagania i badania

## 3 Oznaczenie

KLESZCZE PROTETYCZNE UNIWERSALNE  
KRAMPONOWE ZWYKŁE BN-68/5926-07


## 4 Główne wymiary w mm — wg rysunku

**5 Materiał** Części kleszczy powinny być wykonane ze stali następujących gatunków  
ramiona — 4H13 — wg PN-66/H-86020,  
kołek — 2H13 lub 3H13 — wg PN-66/H-86020

**6 Twardość** ramion po obróbce cieplnej powinna wynosić

rękojesci —  $HRC = 43-48$ ,  
części pracujących, co najmniej —  $HRC = 54$

**7 Działanie** Kleszcze powinny przecinać drut stalowy kwasoodporny sprężysty (np Remanit-federhart) o średnicy 0,9 mm na całej długości ostrzy Kleszcze nie powinny ulec trwałym odkształceniom ani uszkodzeniom krawędzi tnących

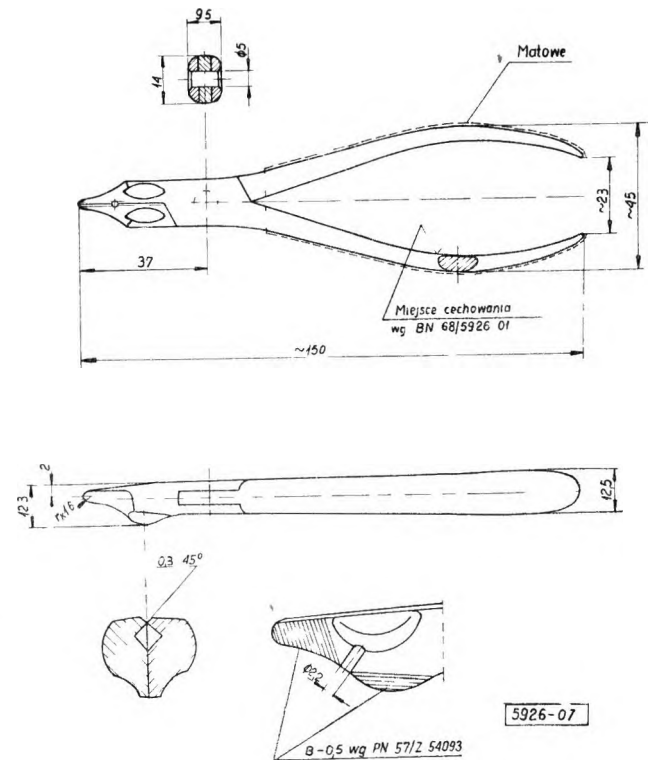

Po zamknięciu kleszczy krawędzie tnące szczęk powinny przylegać do siebie na całej długości

**8 Pozostałe wymagania i badania** — wg BN-68/5926-01

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/5926-07

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/5926-07 Zmieniono materiał kleszczy

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed dnia 29 lipca 1968 r  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r  
(Mon Pol nr 40/1968 poz 285)