

ORTOPEDIA	NORMA BRANŻOWA		BN-70
	Wyroby ortopedyczne Pasy brzuszne przy opuszczeniu żołądka męskie		5995-30
			Grupa katalogowa XIV 26 ¹⁾
Orthopaedic appliances Men abdominal support for gastroenteroptosis cases	Articles orthopédiques Ceintures ventrales lors de ptose d'estomac pour hommes	Ортопедические изделия Бандажи животов при опущении желудков мужские	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pasy brzuszne przy opuszczeniu trzewi (żołądka, jelit) męskie stosowane przy wiotkich powłokach brzusznych.

2. Normy i dokumenty związane

PN-57/H-84026 Stal automatowa. Pręty i walcówka.
Warunki techniczne
PN-65/H-84032 Stal sprężynowa (resorowa). Gatunki
PN-68/P-22218 Skóry podszewkowe. Wymagania
PN-66/P-82037 Tkaniny bawełniane. Flanele białe
PN-69/P-84502 Wyroby szyte. Ściegi. Nazwy i oznaczenia
BN-70/5995-31 Wyroby ortopedyczne. Pasy brzuszne. Wymagania i badania
BN-62/8511-01 Wyroby metalowe. Oczka szewskie
Systematyczny Wykaz Wyrobów, GUS t.III Wydawnictwo
Katalogowe i Cenników Warszawa 1968 r.
Systematyczny Wykaz Asortymentowy 2885. Wyroby Or-

topedyczne. Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego, Warszawa 1969 r.

3. Podział i oznaczenie wyrobów - wg SWW i SWA, podbranzą 2885-340 przy czym, po kresce ukośnej należy oznaczenie uzupełnić symbolami wynikającymi z dalszego podziału.

4. Wielkości. W zależności od obwodu górnego rozróżnia się cztery wielkości pasów:

wielkość 1 - obwód górny 66 cm,
wielkość 2 - obwód górny 72 cm,
wielkość 3 - obwód górny 76 cm,
wielkość 4 - obwód górny 86 cm.

5. Przykład oznaczenia pasa brzuszego przy opuszczeniu żołądka męskiego, o obwodzie górnym 66 cm, wielkości 1:


PAS PRZY OPUSZCZENIU ŻOŁĄDKA MĘSKI 2885-340+22/1
BN-70/5995-30

6. Główne wymiary w cm - wg rysunku 1 tabl. 1.


¹⁾ Symbol wg SWA: 2885-340+22.

Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego dnia 21 grudnia 1970 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1 października 1971 r.
(Mon Pol nr 13/1971 poz 102)

Widok z przodu

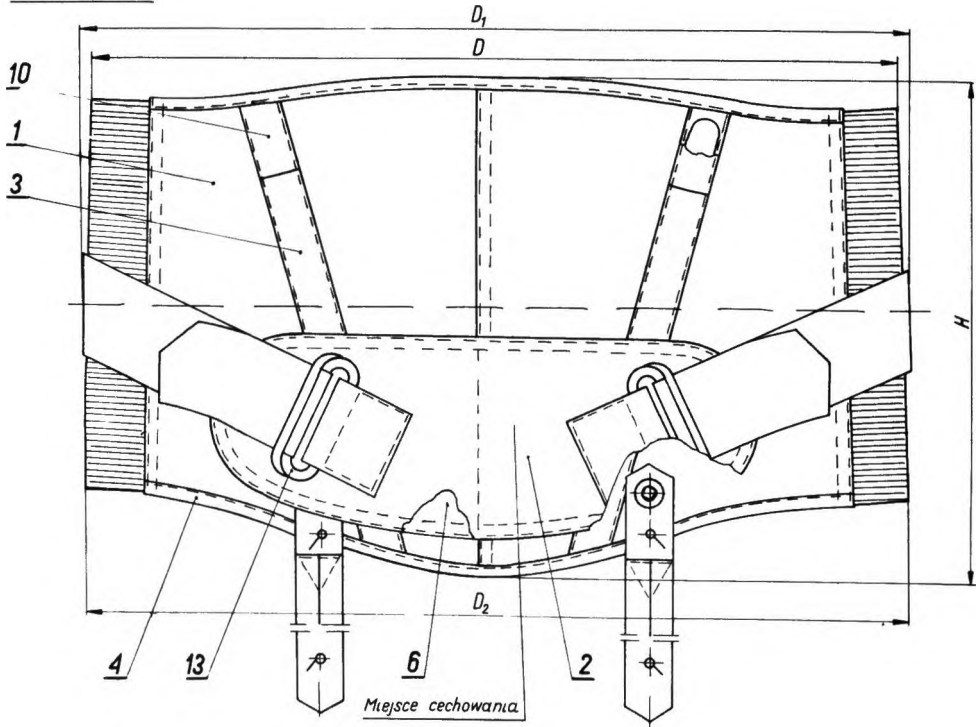

Widok z boku

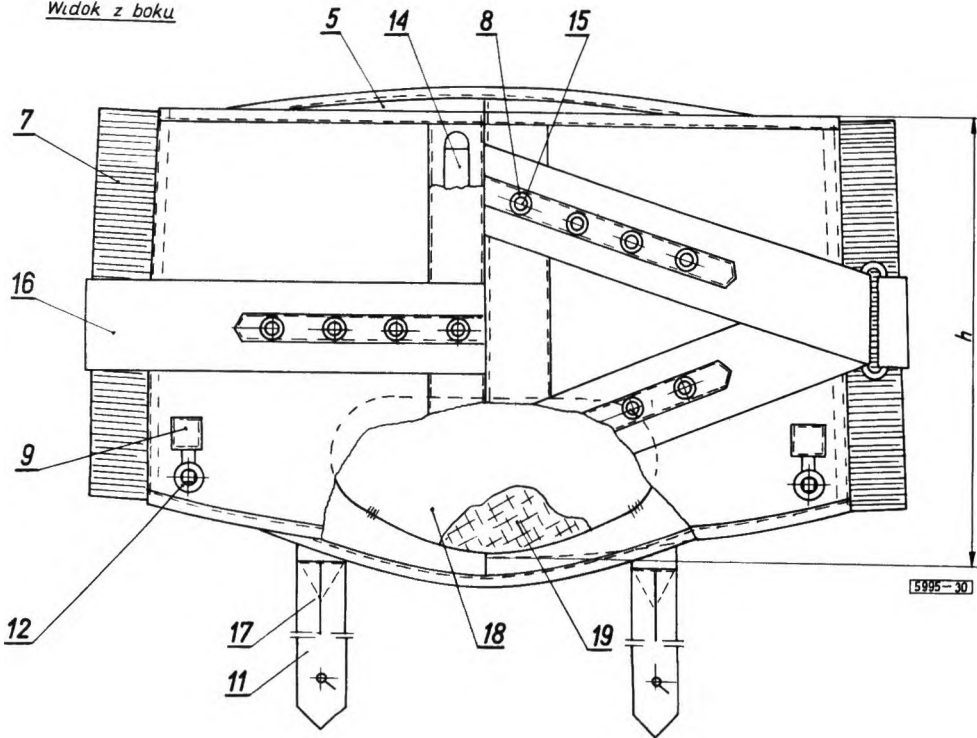

Tablica 1

Wielkość		1	2	3	4
obwód górny	D	66	72	76	86
obwód środkowy	D_1	74	78	84	94
obwód dolny	D_2	80	82	90	100
wysokość przodu	H	18	20	22	26
wysokość tyłu	h	15	16	18	20

7. Materiał i wyszczególnienie części - wg tabl. 2.

Tablica 2

Numer części na rysunku	Nazwa części	Wyróżnik oznaczenia normy	Numer normy	Ilość sztuk	Materiał wg
1	Wykrój zewnętrzny pasa	-	-	2	tkanina gorsetowa SWW 1945-7-2/WS8840
2	Podtrzymywacz, część zewnętrzna	-	-	1	
3	Pliska	-	-	2	
4	Lamówka	-	-	2	
5	Wykrój wewnętrzny pasa	-	-	2	tkanina pościelowa SWW 1936-22/L2055 wykrój wewnętrzny pasów wielkości 4 wykonąć z tkaniny pościelowej SWW 1936-19/BT81/140
6	Podtrzymywacz, część wewnętrzna	-	-	-	
7	Wkładki elastyczne	-	-	4	taśma gorsetowa SWW+SWA 1961-75/N-160
8	Oczka szewskie	St-00b-1600 Ms	BN-62/8511-01	12±20	-
9	Nakładki krótkie	-	-	2	skóra F 12211 PN-68/P-22218
10	Nakładki długie	-	-	4	
11	Paski skórzane	-	-	4	
12	Guziki gorsetowe	-	-	4	nie normalizuje się
13	Klamra	-	-	4	nie normalizuje się
14	Stalki	-	-	4	50 HF PN-65/H-84032
15	Zaczepty	-	-	4	stal A10 lub A12 PN-57/H-84026
16	Taśma	-	-	3	taśma ortopedyczna SWW+SWA 1961-55/6514
17	Podpinka	-	-	2	tkanina flanelowa SWW 1917-1
18	Ochroniacz peloty	-	-	1	
19	Pelota	-	-	1	filc SWW+SWA 2026-44+5

8. Wykonanie. Wszystkie ściegi w szwach - Cp ¹/₂ wg PN-69/P-84502. Na pasach, paskach oraz dodatkach niedopuszczalne są plamy, uszkodzenia mechaniczne, fałdy i błędy ściegów.

9. Cechowanie. Na każdym pasie na wewnętrznej stronie podtrzymywacza, w miejscu wskazanym na ry-

sunku, powinna być umieszczona w sposób trwały i wyraźny cecha zawierająca co najmniej następujące dane:

- znak lub nazwę wytwórni,
- oznaczenie wg 5 (bez części słownej).

10. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-70/5995-31.

K O N I E C

1 W punkcie 2 zamiast Normy i dokumenty związane, powinno być Normy związane

Skresla się następującą treść

PN-68/P-22218 Skóry podszewkowe Wymagania

Uzupełnia się następującymi normami

PN-71/P-82656 Typowe tkaniny jedwabne gorsetowe

PN-71/P-86012 Filce techniczne filtracyjne i uszczelkowe podkładowe


BN-68/6355-01 Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu

Tkaniny obciowe

Skresla się następującą treść

Systematyczny Wykaz Wyrobów, GUS t. III Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 r Systematyczny Wykaz Asortymentowy 2885 Wyroby Ortopedyczne, Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego, Warszawa 1969 r

Widok z przodu

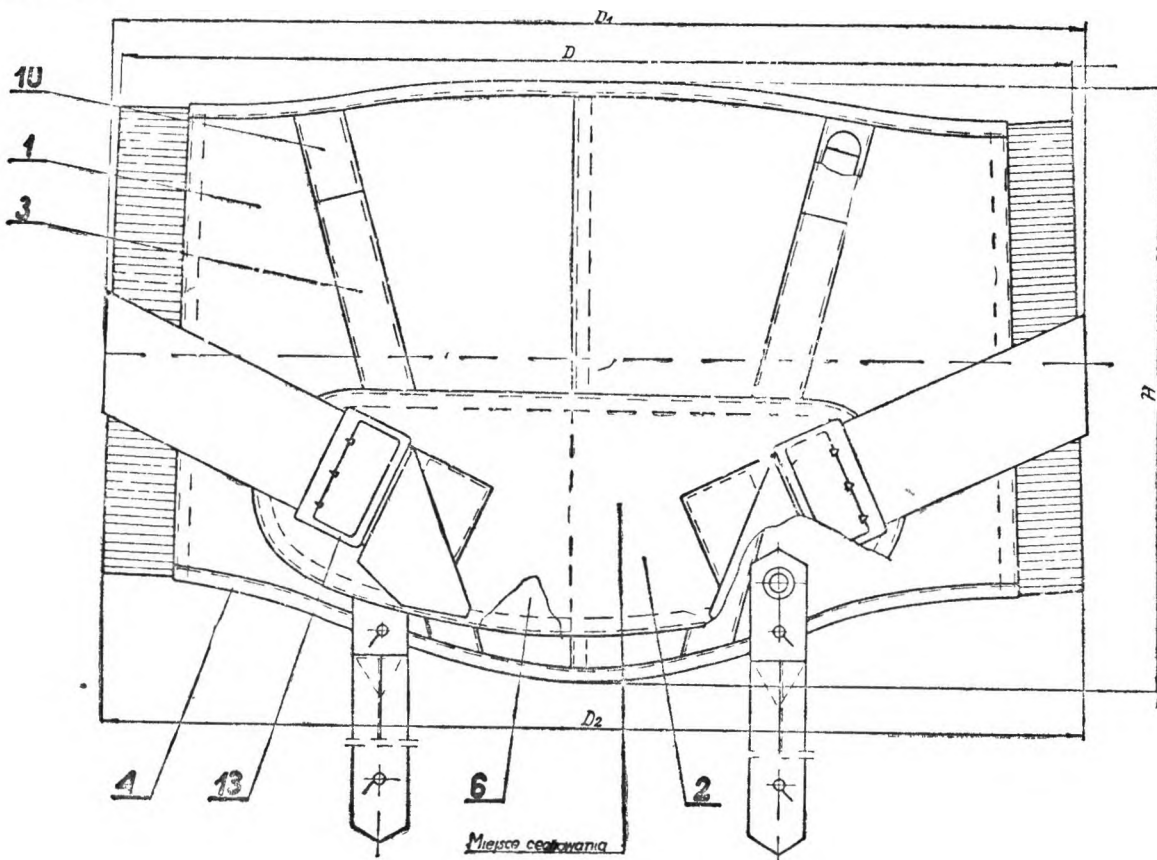

2 Treść punktu 3 skreśla się, pozostałe punkty odpowiednio przenumerować się

3 W punkcie 4 — zamiast 4 Przykład oznaczenia pasa brzuszego przy opuszczeniu żołądka męskiego o obwodzie górnym 66 cm, wielkości 1

PAS PRZY OPUSZCZENIU ŻOŁĄDKA — MĘSKI 2885-340—22

BN-70/5995-30, powinno być 4 Przykład oznaczenia pasa brzuszego przy opuszczeniu żołądka męskiego o obwodzie górnym 66 cm wielkości 1:

PAS PRZY OPUSZCZENIU ŻOŁĄDKA — MĘSKI 1 BN-70/5995-30

4 Dotychczasowy rys — widok z przodu zmienia się następująco (rys na kol 23)

5 W rysunku zamiast widok z boku, powinno być widok z tyłu

6 W tablicy 2 w pozycji od 1 do 4 w rubryce materiał zamiast tkanina gorsetowa SWW 1945-7-2-/WS 8840, powinno być tkanina gorsetowa J 2398 PN-71/P-82656

7 W pozycji od 9 do 11 w rubryce materiał zamiast skóra F 12211 PN-68/P-22218, powinno być tkanina obciowa BN-68/6355-01

8 W pozycji 13 w rubryce liczba sztuk zamiast 4 powinno być 2+1

9 W pozycji 17 i 18 w rubryce materiał zamiast tkanina flanelowa SWW 1917-1 powinno być tkanina flanelowa PN-66/P-82037

10 W pozycji 19 w rubryce materiał zamiast filc SWW+SWA 2026—44+5, powinno być filc PN-71/P-86012